

## รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ประจำไตรมาสที่ 2/2562


### ภาพรวมการค้าอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทย ไตรมาสที่ 2/2562

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยในไตรมาสที่สองปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน) มีมูลค่ารวมการนำเข้า-ส่งออกเท่ากับ 43,920 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว 2.10% หรือคิดเป็นมูลค่า 903 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.53% หรือคิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท

มูลค่ารวมการนำเข้า-ส่งออกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่สอง ปี2562 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ตลาดกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (DURABLE MEDICAL DEVICES) ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด 5.04% ส่วน กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (DISPOSABLE MEDICAL DEVICES) และ กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค (REAGENT AND TEST KITS) มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.27% และ 1.11% ตามลำดับ

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 พบว่ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.36% และ 0.28% ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค มูลค่าลดลง 3.53%<sup>1</sup>

รูปที่ 1 มูลค่ารวมของตลาดในช่วงไตรมาสที่สาม 2561 – ไตรมาสที่สอง 2562

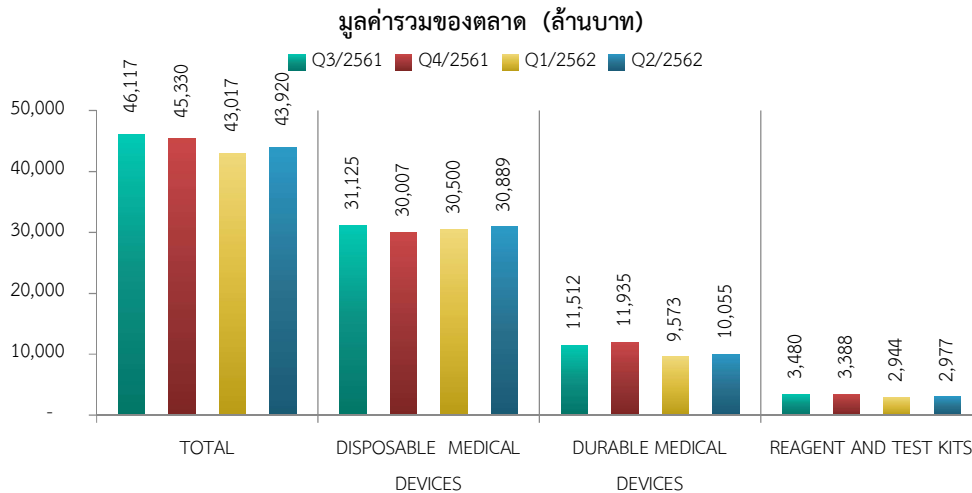

<sup>1</sup> ที่มา [medicaldevices.oie.go.th](http://medicaldevices.oie.go.th)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบมูลค่ารวมของตลาดในไตรมาสที่สอง ระหว่างปี 2561 และ 2562

No.	Group Product	Q2/2018 Value (Million Baht)	Q2/2019 Value (Million Baht)	% Change
1	DISPOSABLE MEDICAL DEVICES	28,507	30,889	8.36
2	DURABLE MEDICAL DEVICES	10,027	10,055	0.28
3	REAGENT AND TEST KITS	3,086	2,977	-3.53
	<b>Total</b>	<b>41,620</b>	<b>43,920</b>	<b>5.53</b>

### การนำเข้า


มูลค่าการนำเข้ารวมของอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ไตรมาสที่สองปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน) มีมูลค่ารวมการนำเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว 5.59% หรือคิดเป็นมูลค่า 911 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.90% หรือคิดเป็นมูลค่า 1,111 ล้านบาท

มูลค่าการนำเข้ารายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่สองปี 2562 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว พบว่ากลุ่มกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็น 12.49% กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.60% และ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.73%

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 พบว่า กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.66% กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.12% และ กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคมูลค่าลดลง 4.49% ตามลำดับ<sup>2</sup>

<sup>2</sup> ที่มา medicaldevices.oie.go.th

รูปที่ 2 มูลค่าการนำเข้าในช่วงไตรมาสที่สาม 2561 – ไตรมาสที่สอง 2562

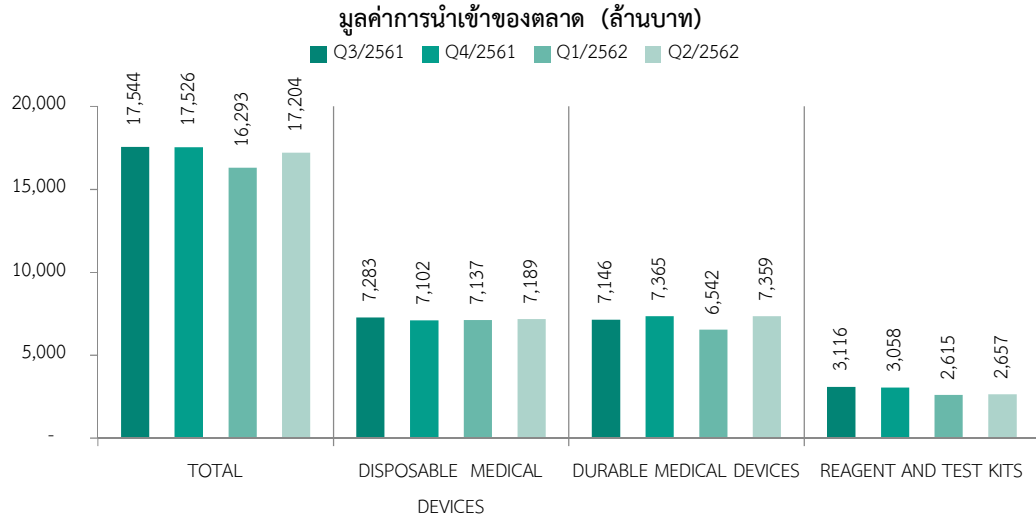

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าในไตรมาสที่สอง ระหว่างปี 2561 และ 2562

No.	Group Product	Q2/2018	Q2/2019	% Change
		Value (Million Baht)	Value (Million Baht)	
1	DISPOSABLE MEDICAL DEVICES	7,109	7,189	1.12
2	DURABLE MEDICAL DEVICES	6,202	7,359	18.66
3	REAGENT AND TEST KITS	2,782	2,657	-4.49
<b>Total</b>		<b>16,093</b>	<b>17,204</b>	<b>6.90</b>


### การส่งออก

มูลค่าการส่งออกรวมของอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ไตรมาสที่สองปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน) มีมูลค่ารวมการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว 0.03% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.66% หรือคิดเป็นมูลค่า 1,189 ล้านบาท

มูลค่าการส่งออกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่สองปี 2562 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว พบว่ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.44% ในขณะที่กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค มูลค่าลดลง 2.76% และ กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีมูลค่าลดลง 11.04%

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 พบว่ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด 7.39% กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.61% และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าลดลง 29.50% ตามลำดับ<sup>3</sup>

รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกในช่วงไตรมาสที่สาม 2561 – ไตรมาสที่สอง 2562

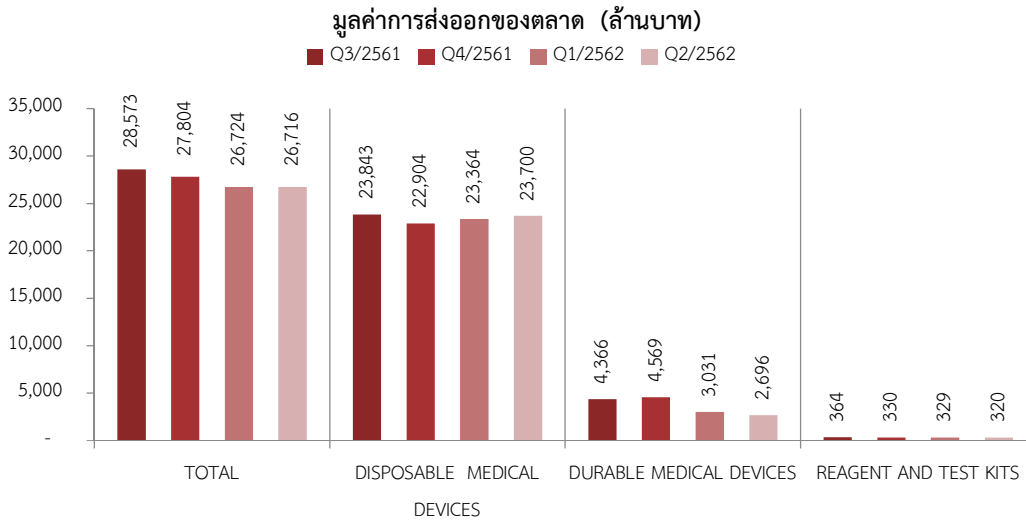

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกในไตรมาสที่สอง ระหว่างปี 2561 และ 2562

No.	Group Product	Q2/2018 Value (Million Baht)	Q2/2019 Value (Million Baht)	% Change
1	DISPOSABLE MEDICAL DEVICES	21,398	23,700	10.76
2	DURABLE MEDICAL DEVICES	3,824	2,696	-29.50
3	REAGENT AND TEST KITS	303	320	5.61
<b>Total</b>		<b>25,527</b>	<b>26,716</b>	<b>4.66</b>

<sup>3</sup> ที่มา [medicaldevices.oie.go.th](http://medicaldevices.oie.go.th)